ARRIVO DEL DMR AL BLOCCO OPERATORIO/CDS

PRIMO CICLO DI STERILIZZAZIONE:

CORRETTE METODOLOGIE PER PRESERVARE LA QUALITA' DELLO STRUMENTO

Oriana Rossi
Infermiera
CdS E.O.Galliera Genova

KEYWORD:

Scheda Tecnica- IFU

La scelta del metodo di sterilizzazione avviene tenendo conto delle indicazioni del fabbricante del dispositivo da processare .

Le indicazioni devono riguardare la scelta del metodo, la temperatura e la possibilità di riprocessare il DMR.

Pertanto è imperativo esigere la documentazione di accompagnamento del dispositivo medico prima di sottoporlo al processo di sterilizzazione.

INGRESSO DEL DMR C/O BLOCCO-CDS

Autorizzazione DS

↓

Documentazione completa

↓

Protocollo Aziendale

↓

Controllo DMR

↓

DMR STERILE

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

E.O. Ospedali Galliera di Genova

DIREZIONE SANITARIA
Struttura a Semplice Igiene Ospedaliera e Logistica

RICHIESTA STERILIZZAZIONE STRUMENTAZIONE o SET CHIRURGICI

Alla Direzione Sanitaria
Sede

Descrizione strumentazione/set chirurgico (tipologia, Azienda fornitrice): .....

Motivo richiesta

Intervento chirurgico ☐ data di utilizzo .....
Procedura diagnostica ☐ data di utilizzo .....

Data .....

Timbro e Firma del Responsabile

Da compilarsi a cura della Direzione Sanitaria

Parere favorevole SI ☐ NO ☐

La sterilizzazione verrà effettuata unicamente se il materiale perverrà nei tempi e modi già indicati e completo di schede tecniche relative alla sterilizzazione.

Alla Responsabile della Centrale di sterilizzazione

Il Direttore Sanitario .....

Aesculap Surgical Instruments

GB Instructions for use/Technical description
Pneumatic clip applier (with detachable titanium clip magazine)
USA
D Gebrauchsanweisung/Technische Beschreibung
Pneumatischer Clip-Applikator (mit einsetzbarem Titanclip-M
F Mode d'emploi/Description technique
Applicateur pneumatique de clips (avec magasin de clips en
E Instrucciones de manejo/Descripción técnica
Aplicador de clips neumático (con cargador de clips de tit
I Istruzioni per l'uso/Descrizione tecnica
Applicatore per clip pneumatico (con caricatore per cli
P Instruções de utilização/Descrição técnica
Aplicador pneumático de clips (com carregador amo
NL Gebruiksaanwijzing/Technische Beschrijving
Pneumatische clipsapplicator (met inzetbaar titani
DK Brugsanvisning/Teknisk Beskrivelse
Pneumatisk clipsapplikator (med titanclips-mag
S Bruksanvisning/Teknisk Beskrivning
Pneumatisk clipsapplikator (med

E.O. OSPEDALI GALLIERA - GENOVA

PROTOCOLLO ACCETTAZIONE DISPOSITIVI MEDIC RISTERILIZZABILI

PREPARATO	VERIFICATO	APPROVATO
N. Cenderello M. Deidda P. Fabbri M.G. Tagliafico.	M. Nelli	T. Chiossone
Data: maggio 2006	Rev 0	Descrizione delle modifiche: Prima emis

Documento contenuto nel prodotto Sanità - Sterilizzazione - Dispositivi medici edizione 2008
E' vietato l'uso in rete del singolo documento e la sua riproduzione. E' autorizzata la stampa per uso interno.

NORMA EUROPEA

Sterilizzazione dei dispositivi medici
Informazioni che devono essere fornite dal fabbricante per i processi di dispositivi medici risterilizzabili

UNI EN ISO 17664

GIUGNO 2005

Sterilization of medical devices
Information to be provided by the manufacturer for the processing of resterilizable medical devices

La norma specifica le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante di dispositivi medici sul processo di dispositivi medici dichiarati come risterilizzabili e sui dispositivi medici destinati ad essere sterilizzati dal responsabile dei processi.

Ente Ospedaliero Ospedali Galliera Genova
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione

PREPARAZIONE DEI DMR AL LAVAGGIO

Il lavaggio di un DM costituisce un prerequisito essenziale per un'efficace azione delle fasi successive di disinfezione e/o sterilizzazione.

L'efficacia dell'azione di lavaggio sui DM viene ostacolata non solo dalla presenza di residui organici fissati sulle superfici, ma nel caso di DMR nuovi anche dalla presenza di sostanze lubrificanti (oli siliconici etc) applicati sul DMR al fine di preservarne la funzionalità fino al momento della messa in commercio.

B|BRAUN SHARING EXPERTISE

SMONTARE QUANDO POSSIBILE I DMR COMPOSTI DA PIU' PARTI

Disassemblaggio

I **Disattivare la cremagliera dell'impugnatura**
Abbassare il bottone di blocco rosso.
N.B. solo per il PO959R

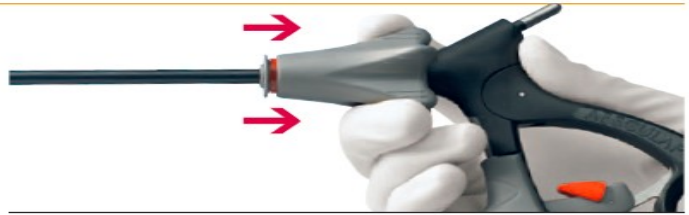

II **Disconnettere l'asta dall'impugnatura**
Trazionare la ghiera rotante fino al blocco.
Sarà visibile un anello rosso.
Importante:
durante l'operazione non impugnare parti mobili del manipolo.

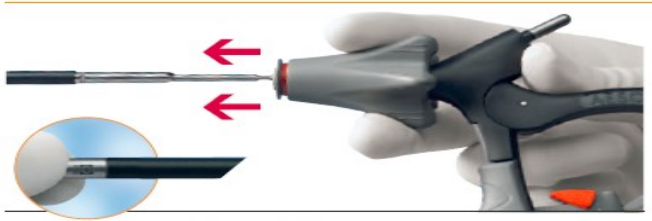

III **Rimuovere l'asta dall'impugnatura**
Estrarre l'asta trazionandola fuori dall'impugnatura.

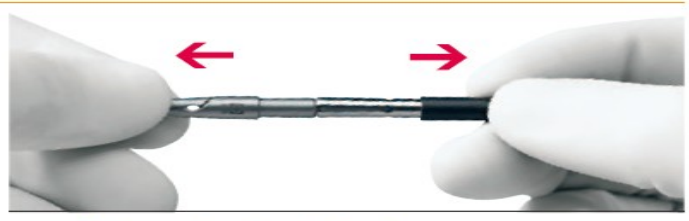

IV **Disassemblare l'asta dal tubo esterno**
Tenere il morso dalla parte della punta
e rimuovere il tubo isolante.

LAVAGGIO DMR

Nel caso di DMR NUOVI procedere a due cicli di detersione.

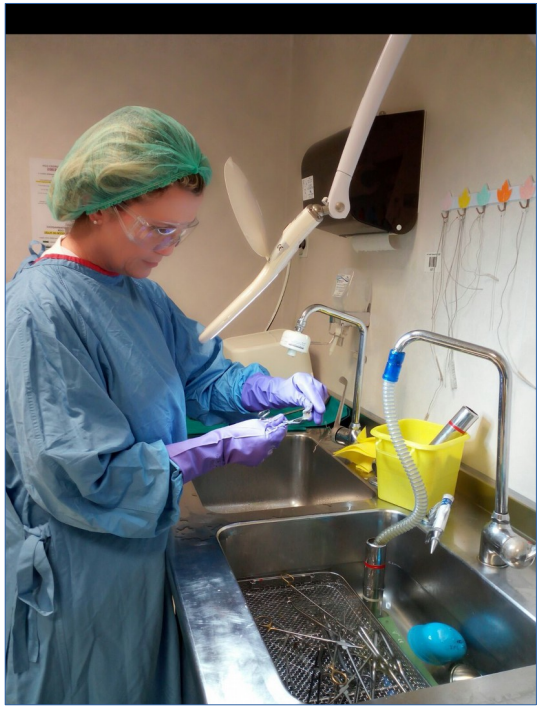

B|BRAUN SHARING EXPERTISE

B|BRAUN SHARING EXPERTISE

RICOMPOSIZIONE KIT CHIRURGICI E STERILIZZAZIONE

Procedere alla lubrificazione degli strumenti a snodo e/o incastro prima della ricomposizione dei kit

KIT: NON SUPERARE I 10 Kg di peso

Ente Ospedaliero Ospedali Galliera Genova
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione

B|BRAUN SHARING EXPERTISE

B|BRAUN SHARING EXPERTISE

Procedere al riassemblaggio dei DMR solo post sterilizzazione

Istruzioni fabbricante

Assemblaggio

I **Assemblare l'asta con il copri inserto**
Inserire il tubo interno di metallo nel morso seguendo le 4 linguette guida, fino al punto di blocco.

II **Assemblare l'asta con il tubo esterno**
Inserire il tubo isolante esterno fino a che non copra integralmente quello interno in metallo.

III **Preparare l'impugnatura**
Se l'anello rosso non è visibile, ritrarre la ghiera rotante.
Disattivare il blocco della cremagliera abbassando il bottone rosso.

N.B. solo per PO959R

IV **Connettere l'asta con l'impugnatura**
Tenere fermamente l'asta dalla parte della punta e l'impugnatura nella zona dietro la ghiera rotante.
Spingere l'asta all'interno del manico fino al suo blocco, bloccandosi la ghiera scatta e l'anello rosso scompare.

Importante:
non bloccare le componenti mobili dell'impugnatura.

Ente Ospedaliero Ospedali Galliera Genova
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Ente Ospedaliero
Ospedali Galliera
Genova
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione